



SRS **2**
CIBAO SUR
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

Proceso Compra Menor **RSCS-DAF-CM-2025-0073**

Especificaciones técnicas.

ADQUISICION DE AUTOCLAVES DENTALES PARA SER UTILIZADAS EN EL CPN TIREO, CPN PASO BAJITO, CDX VILLA LA MATA Y CDX LA VEGA, PERTENECIENTES A ESTE SRSCS.

CONSULTAS

Los interesados podrán solicitar a **SRSCC** aclaraciones acerca del pliego de condiciones específicas mediante consultas realizadas vía correo electrónico, compras@srsviii.gob.do hasta la fecha establecida en el cronograma.


DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN:

EL OFERENTE DEBERÁ OFERTAR LO SIGUIENTE:

Código	ítem	Cantidad	Presentación	Descripción
42281508	1	4 UNDS	AUTOCLAVES DENTALES	Característica del producto -Clase B -16 Litros Ciclos de esterilización cortos y largos -Ciclos de esterilización cortos y largos -Tanque de agua de tipo abierto, que es muy fácil para el llenado de agua y limpieza -110 voltios -Un protector de la electricidad-fugas -temperatura 121 C 7 134 C -Presión 0.12 Mpa -Tiempo de esterilización 25 minutos/ 6 minutos

				<ul style="list-style-type: none"> -Control precisión temperatura 1 c Presión 0.1bar -Acero inoxidable medico 304 Max, superior. -Temperatura máxima 145 -Redondo -semiautomático -Tres bandejas -Mínimo 18 meses de garantía en piezas y servicios -Piezas y mano de obra disponible en el país. -Tiempo de respuesta para atención por desperfectos del equipo: Tres (3) días.
--	--	--	--	---

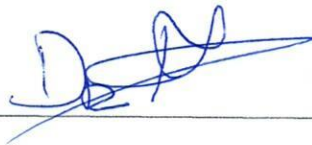

Dr. Richard Caceres



SUPERVISOR DEPTO. ODONTOLOGIA DEL SRSCCS.